Hügieenijuhis

HEKA

Loodud hügieeni tarvis

Heka S+ on loodud nii hügieeniliseks ja lihtsasti puhastatavaks kui võimalik. See sisaldab hästi läbimõeldud üksikasju, näiteks pinnana on kasutatud karastatud klaasi, mida oma kõva ja sileda pinna tõttu saab eriti tõhusalt puhastada ja desinfitseerida. Integreeritud puuteekraan tagab, et puuduvad igasugused nupud ja lülitid, mis võiks tolmu ja mustust koguda.

Üldine pinnapuhastus

Kõik seadme pinnad on kas pulberkattega alumiiniumist või karastatud klaasist. Loomulikult saab ekraani puhastamise ajaks lukustada ning see avaneb automaatselt 2 minuti järel, seega on seade taas enne järgmise patsiendi saabumist kasutusvalmis.
Kõiki kontaktpunkte - käepidemeid ja instrumendi tugesid - saab puhastamiseks ja autoklaavimiseks lihtsasti eemaldada.
See kehtib ka OP-lambi käepidemete kohta.

Automaatne instrumendiloputus

Seadme veesüsteemi ja instrumendi voolikute tõhus loputamine on seadme biokilevabana hoidmisel väga oluline tegur. Automaatne instrumendiloputus muudab instrumendi voolikute igapäevase ja patsientide vahelise loputamise lihtsaks, kiireks ja tõhusaks. Instrumendiloputuse järel on lihtne aktiveerida süljekausi loputust, et loputada ka seda veesüstee mi osa.

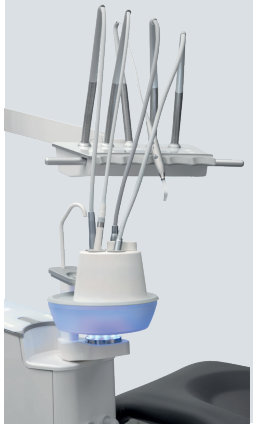

Imuri puhastussüsteem

Automaatse imemisega käivitatakse imivoolikute otsas otsakud, mis puhastavad imisüsteemi järjepidevalt kemikaalide või lihtsalt puhta veega, ning see aitab kogu imisüsteemi puhta ja tõhusana hoida Kemikaalide või ainult veega loputamist on võimalik käivitada patsiendi kallal töötades.

See tagab igasuguse mustuse eemaldamiseilma vooliku ärakuivamiseta, et vältida mustuse tahkumist vooliku sees.

Regulaarne aktiivsete kemikaalidega loputus patsientide vahel või õhtul saab tagada kolooniaid moodustavate osakeste, mikroobide ja bakterite vähendamise imisüsteemis.

Süljekauss / süljekausi klapp / võimalik amalgaamiseparaator

Tagab tõhusa veevoolu süljekausisüsteemist. Amalgaamiseparaator eemaldab süljekausi veest ka amalgaami.

Süljekaussi saab puhastamise jaoks hõlpsalt eemaldada.

Aktiivne veepuhastus

Kui valiti aktiivne veepuhastus, doseeritakse aktiivpuhastusvedelikku järjepidevalt seadme veesüsteemi, et hoida mikroorganismide arvukust madalana ning vältida biokile teket. Veepuhastussüsteem on saadaval kahes variandis: ilma DVGW heakskiidetud veekaskaadiga ja koos sellega.

Seadmepuhastusprotseduurid

Hommikul

- Loputage instrumente automaatse instrumendiloputusega - pikk programm
- Loputage imisüsteemi, kasutades automaatse imemisega puhastust (või imedes puhastusvedelikku sisse).

Enne iga patsienti

- Pindade ja instrumendivoolikute puhastamine ja desinfitseerimine, sealhulgas käepidemed ja tooli polster
- Lühike instrumentide pesu koos automaatse instrumendiloputusega
- Imisüsteemi aktiivsete kemikaalidega läbiuhtumine selle sisemiseks puhastamiseks, imuri käsitsetavaid osi puhastatakse ja pühitakse heakskiidetud desinfitseerimisvahendiga.

Õhtul

- Loputage imisüsteemi aktiivsete kemikaalidega. Imuri käsitsetavad osi eemaldatakse ja puhastatakse kliiniku regulatsioonide järgi
- Kontrollige ja puhastage imivoolikute filtreid
- Eemaldage käepidemed ja instrumendi toed - puhastage ja autoklaavige praksise regulatsioonide järgi.

Muu (vajaduse korral)

- Kontrollige ja vajadusel lisage imuri puhastisse ja/või aktiivsesse veepuhastisse kemikaale
- Kontrollige süljekausi klappi/äravoolufiltrit ning vajadusel puhastage neid
- Asendage amalgaamianum, kui see on täitunud.

Need on üldjuhised. Loomulikult tuleb seadet alati puhastada kehtivate juhiste järgi.

Palun vaadake ka kasutusjuhendit: KA-0111, et näha üksikasjalikke juhiseid, kuidas teha vajalikku puhastust seadmele Heka S+.

HEKA

Heka Dentali dokument: KA-0260